


NEDFORM

KATALOG 2026

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

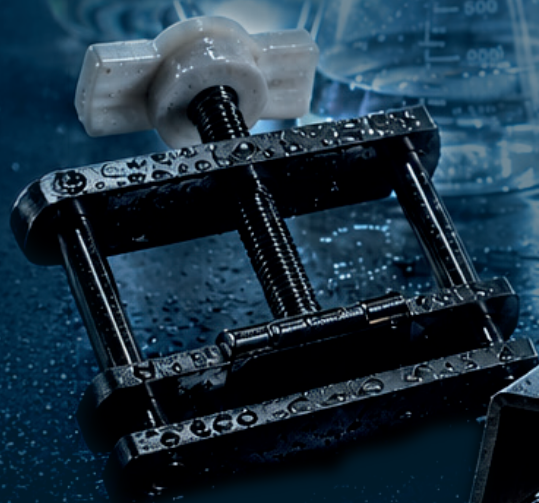


01

DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ DP – 4RST

0101


Objednávkové číslo	Napětí	Příkon	Výkon přístroje	Hmotnost
632 612 008 110	230V/50Hz	2,8 kW	3,5 – 4 l/h	10,5 kg

Destilační přístroj je určen pro destilaci pitné vody v lékárnách, laboratořích a pro další pracoviště, kde je spotřeba destilované vody za pracovní směnu 15 až 30 litrů. Destilační přístroj je sestaven z varného kotlíku s chladičem, víka, topení, svor-kovnice, deflegmentační vložky, odkalovací vložky, odpadní trubice a elektrické jistící skříňky. Je vybaven teplotním čidlem, které vypíná přístroj pokud není voda ve varném kotlíku. Destilační přístroj DP – 4RST (závěsný) má nosnou konstrukci pro zavěšení přístroje a destilační přístroj DP – 4RST (stolní) má zásobní nádržku na destilovanou vodu.


02

DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ DP – 4RZT



Objednávkové číslo	Napětí	Příkon	Výkon přístroje	Hmotnost
632 612 008 210	230V/50Hz	2,8 kW	3,5 – 4 l/h	10,5 kg

Destilační přístroj je určen pro destilaci pitné vody v lékárnách, laboratořích a pro další pracoviště, kde je spotřeba destilované vody za pracovní směnu 15 až 30 litrů. Destilační přístroj je sestaven z varného kotlíku s chladičem, víka, topení, svor-kovnice, deflegmentační vložky, odkalovací vložky, odpadní trubice a elektrické jistící skříňky. Je vybaven teplotním čidlem, které vypíná přístroj pokud není voda ve varném kotlíku. Destilační přístroj DP – 4RZT (závěsný) má nosnou konstrukci pro zavěšení přístroje a destilační přístroj DP – 4RST (stolní) má zásobní nádržku na destilovanou vodu.





03 DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ IDPE 10



Objednávkové číslo	Typ	Napětí	Příkon	Výkon přístroje	Hmotnost
632 612 009 007 IDPE 10	4-7 °N	3* 400V / 50Hz	5,9 – 10,5kW Výkon	7,4 – 14,5 l/h	15 kg
632 612 009 012 IDPE 10	8-18 °N	3* 400V / 50Hz	5,9 – 10,5kW Výkon	7,4 – 14,5 l/h	15 kg
632 612 009 017 IDPE 10	19-25 °N	3* 400V / 50Hz	5,9 – 10,5kW Výkon	7,4 – 14,5 l/h	15 kg
632 612 009 022 IDPE 10	grafit.topení	3* 400V / 50Hz	5,9 – 10,5kW Výkon	7,4 – 14,5 l/h	15 kg
632 612 010 015 IDPE 10 ZF	_____	3* 400V / 50Hz	5,9 – 10,5kW Výkon	7,4 – 14,5 l/h	45,70 kg
632 911 980 010 stojan	_____	_____	_____	_____	23 kg

Destilační přístroj je určen pro destilaci pitné vody v lékárnách, laboratořích a pro další pracoviště, kde je spotřeba destilované vody za pracovní směnu 15 až 30 litrů. Destilační přístroj je sestaven z varného kotlíku s chladičem, víka, topení, svorkovnice, deflegmentační vložky, odkalovací vložky, odpadní trubice a elektrické jističí skříňky. Je vybaven teplotním čidlem, které vypíná přístroj pokud není voda ve varném kotlíku. Destilační přístroj DP – 4RZT (závěsný) má nosnou konstrukci pro zavěšení přístroje a destilační přístroj DP – 4RST (stolní) má zásobní nádržku na destilovanou vodu.

04 ELEKTRICKÁ LÁZEŇ EL – 20 D



Objednávkové číslo	Typ	Napětí	Příkon	Nejvyšší teplota	Výkon přístroje	Pracovní prostor	Hmotnost
396 321 112 350	Typ EL – 20 D	230V	2275 VA	100 °C (dáno nastavením regulátoru)	± 0,1 °C (po ustálení teploty a zapnutým míchadlem)	350 x 350 mm	17 kg

Přístroj se používá k nepřímému zahřívání nádob s látkami, které nesmějí přijít do přímého styku se zdrojem tepla a tam, kde je nutné dodržovat velmi přesně teplotu ohřevu. Elektrická lázeň se skládá z vany, na níž je nasazen elektronický regulátor teploty s digitálním zobrazováním nastavených i skutečných hodnot a míchadlo. Pracovní prostor vany je uzavřen víkem. Vlastní vana je uložena v tepelně izolované skříni. Ve vaně je umístěn ventil k napouštění a vypouštění vody. Maximální výška hladiny je dána pevně vestavěným přepadem v horní části vany. Vyústění ventilu a přepadu je v zadním panelu skříně. Na panelu elektronického regulátoru jsou spínače a signální světla pro topné těleso a míchadlo. Všechny díly přístroje, které mohou přijít do styku s vlhkostí, jsou vyrobeny z nerezavějících materiálů.



04 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednávkové číslo	Typ
396 321 112 604	Stojánek pro vodní lázeň
396 321 112 603	Stojan pro baňky 2l
396 321 112 601	Zvýšené víko
396 321 112 602	Víko keramických kruhů



05 STERILIZÁTOR KLIČEK



Objednávkové číslo	Typ	Tlak (kPa)	Výkon(kw)	Průměr trysky (mm)	Čas pro sterilizaci	Napětí
396 554 910 107	SPB Propan-butan SZ zemní plyn	2,94 1,71	1,4 1,1	0,6 0,9	6s	230V / 50Hz



Příkon	Rozměr základny	Výška	Hmotnost
2W	120 * 162mm	260 mm	2kg

Přístroj je určen pro sterilizaci bakteriologických kliček z odporového drátu o průměru 0,8 mm. Sterilizátor sestává z účelového uspořádání plynového kahanu s otočným karuselem. Karusel slouží pro uložení držáků kliček a je napojen na mechanismus pohonu, který mu dává přerušovaný rotační pohyb. Upevnění karuselu dovoluje doladění držáků ve vertikálním směru vůči plameni kahanu, do kterého držáky s kličkami zajišťují. V rámu, na kterém je toto uspořádání upevněno, je zabudován vypínač, signální světlo a přívodní šňůra.



06 DRŽÁK BEZ SVORKY



Objednávkové číslo	Typ	Povrch	Délka	Hmotnost
396 551 210 101	Držák 1	korek	186 mm	65 g
396 551 210 103	Držák 1	plast	186 mm	65 g
396 551 210 102	Držák 2	korek	196 mm	75 g
396 551 210 104	Držák 2	plast	196 mm	75 g

Držák je určen pro práci s laboratorním stojanem v laboratoři. Upíná se křížovou svorkou na tyč stojanu. Maximální rozevření čelistí je 40 mm. Výstelka čelistí je z korku. Průměr upínané části je 11 mm.






07

LABORATORNÍ KAHANY



Objednávkové číslo	Typ	Plyn	Tlak	Příkon	Výkon přístroje	Hmotnost
396 554 211 800	Z1	Zemní plyn	1,5 – 2,3	0,13	1300	450 g
396 554 212 100	Z2	Zemní plyn	1,5 – 2,3	0,23	2300	800 g
396 554 211 900	P1	Propan-Butan	2,5– 3,5	0,045	1450	450 g
396 554 212 200	P1	Propan-Butan	2,5– 3,5	0,08	2500	800 g

Laboratorní kahany na plynná paliva se používají v laboratořích a provozech k zahřívání a žíhání látek. Kahany je možné používat pouze v dobře větraných místnostech. Kahan se skládá z podstavce z lisovaného plechu, na kterém je přišroubováno těleso hořáku s přívodem plynu a směšovačem. V dolní části směšovače je clona, jejímž otáčením se reguluje přísávání vzduchu. Druh plynu pro kahan je vyznačen na výrobním štítku na podstavci. Kahany typu Z2 a P2 jsou vybaveny regulačním ventilem.

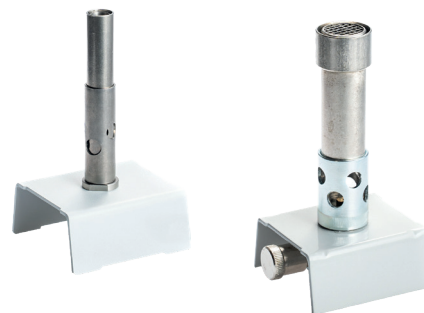

08

STOJAN NA ZKUMAVKY



Objednávkové číslo	Typ	Průměr
396 551 110 803	hliníkový, 22 zkumavek	17 mm
396 900 008 030	mosazný, 12 zkumavek	17 mm



09

DRŽÁK BYRETY



Objednávkové číslo	Typ	Povrch	Délka	Hmotnost
396 551 210 602	Držák byrety (dvojitý)	kov	180 mm	100 g
396 551 210 603	Držák byrety (dvojitý)	plast	180 mm	100 g
396 551 210 601	Držák byrety (jednoduchý)	kov	130 mm	55 g
396 551 210 604	Držák byrety (jednoduchý)	plast	130 mm	55 g

Držák byrety se používá k bezpečnému zavěšení byrety na laboratorní stojan. Držák byrety se skládá z čelistí, které jsou stavitelné a upínací části, která slouží k upnutí na laboratorní stojan.





10

DRŽÁK CHLADIČE



Objednávkové číslo	Typ	Povrch	Délka	Hmotnost
396 551 210 105	Držák Chladiče (střední)	korek	225 mm	85 g
396 551 210 107	Držák Chladiče (střední)	plast	225 mm	85 g
396 551 210 106	Držák Chladiče (velký)	korek	280 mm	150 g
396 551 210 108	Držák Chladiče (velký)	plast	280 mm	150 g

Držák chladiče se používá k bezpečnému zavěšení chladiče na laboratorní stojan. Držák se skládá z čelistí, které jsou stavitelné a dřívku o průměru 11 mm, který slouží k upnutí na laboratorní stojan. Upíná se křížovou svorkou na tyč stojanu.



11

KRUHY NA FILTRACI



Objednávkové číslo	Vnitřní průměr	Délka	Hmotnost
396 551 310 101	30 mm	157 mm	60 g
396 551 310 102	40 mm	162 mm	80 g
396 551 310 103	50 mm	170 mm	90 g

Kruhy jsou určeny jako podložka pod skleněné baňky při práci na laboratorním stojanu v laboratoři. Jsou opatřeny vložkou z umělé hmoty a vyrábějí se.



12

KRUHY NA VAŘENÍ



Objednávkové číslo	Typ	Vnější průměr	Délka	Hmotnost
396 551 316 286	kruh 80	80 mm	225 mm	100 g
396 551 316 287	kruh 106	106 mm	260 mm	200 g
396 551 316 288	kruh 132	132 mm	286 mm	300 g

Kruh na vaření slouží k uložení baněk různých velikostí na laboratorním stojanu. Připevňuje se na tyč pomocí křížové svorky. Vyrábí se ve třech průměrech kruhu pro uložení skleněné baňky na stojanu.





13

KŘÍŽOVÁ SVORKA



Objednávkové číslo	Typ	Délka	Hmotnost
396 551 410 100	kruh80	80 mm	55 g

Křížová svorka je určena k upevňování na laboratorní stojan. Je vyrobena ze slitiny hliníku, upevňovací šroub svorky je ocelový. Nejmenší upínaný průměr je 5 mm a největší upínaný průměr je 12 mm.



14

LABORATORNÍ STOJAN S DESKOU



Objednávkové číslo	Výška	Průměr tyče (mm):	Rozměry desky:	Hmotnost
396 551 110 301	750 mm	12	250 * 160 mm	2,3 kg
396 551 110 302	1000 mm	12	250 * 160 mm	2,5 kg

Stojan je určen pro práci v laboratořích. Deska stojanu je litinová s povrchem opatřeným nátěrovou hmotou a tyč je nerezová. Stojan se vyrábí ve dvou velikostech.



15

UNIVERSÁLNÍ STOJAN BUNSEN



Objednávkové číslo	Výška	Průměr tyče:	Rozměry desky:	Hmotnost
396 551 110 100	750 mm	12 mm	250 * 160 mm	3,6 kg
396 551 110 101-plast	750 mm	12 mm	250 * 160 mm	3,6 kg

Universální stojan se používá v laboratořích k uchycení přístrojů a laboratorních pomůcek v různých polohách. Stojan je dodáván v dílech pro sestavení libovolné kombinace dílů pro práci v laboratoři.

- 1 ks Laboratorní stojan s deskou a tyčí délky 750 mm
- 1 ks Kruh na vaření, průměr 130 mm
- 1 ks Kruh na vaření, průměr 100 mm
- 1 ks Kruh na vaření, průměr 70 mm
- 1 ks Držák na chladič velký
- 1 ks Držák bez svorky 1
- 1 ks Držák bez svorky 2
- 6 ks Křížová svorka





16

TŘÍNOŽKA NA VAŘENÍ



Objednávkové číslo	Typ	Průměr	Délka	Hmotnost
396 553 710 103	Třínožka 120	140 mm	190 mm	360 g
396 553 710 104	Třínožka 150	154 mm	190 mm	450 g

Třínožka je určena na vaření v laboratořích. Je vyrobena z ocelových tyčí a lisovaného plechu. Vyrábí se ve dvojím provedení.



17

DRŽÁK NA ZKUMAVKY



Objednávkové číslo	Průměr x Délka	Hmotnost
396 551 210 501	17 x 225 mm	60 g

Praktická pomůcka pro bezpečné uchopení a manipulaci se zkumavkami při zahřívání, přenášení nebo laboratorní práci.
Ergonomický tvar zajišťuje pohodlné a bezpečné používání.



18

HOFMANOVA TLAČKA



Objednávkové číslo	Velikost (mm):
396 553 110 205	30
396 553 110 206	40

Hofmanova tlačka slouží k regulaci průtoku kapaliny hadicí. Je vyrobena z kovu a vyrábí se ve dvou velikostech.



19

POTRUBNÍ SPONY



Objednávkové číslo	Typ	Průměr	Hmotnost
632 913 001 090	DN25	32 mm	50 g
632 913 001 100	DN50	56 mm	55 g
632 931 001 110	DN80	86 mm	60 g
632 931 001 120	DN100	106 mm	65 g

Spony slouží k bezpečnému upevnění potrubí ke stěnám, ke stropům nebo ke konstrukcím



20

PŘEČERPÁVACÍ NÁSOSKA Z NOVODURU

Objednávkové číslo	Délka	Šířka	Průměr	Poloměr zakřivení trubice:	Hmotnost
396 529 110 100	strana s balónkem 916 mm strana opačná 880 mm	310 mm Poloměr zakřivení trubice 150 mm	15 mm	150 mm	0,75kg

Násoska slouží k bezpečnému přečerpávání agresivních a jiných kapalin z přepravních lahví nebo sudů. Násoska je ohnutá trubka z novoduru, opatřená na jednom konci skleněným nástavcem s ochrannou baňkou, pryžovým balónkem a dvoucestným skleněným kohoutkem. Obsah balónku umožňuje nasát na jedno nasátí kapalinu, aby se dostala přes přepadový bod a dále již samovolně vytékala. Ochranná skleněná baňka zabráňuje vniknutí přečerpávané kapaliny do balónku.




21

ROZPTYLOVAČ PLAMENE

Objednávkové číslo	Materiál	Průměr x Délka	Hmotnost
559 779 207 000	nerez	200 mm	66 kg
559 779 207 001	železo	200 mm	103 kg

Rozptylovač plamene slouží k rovnoměrnému ohřevu nádob vyrobených z ohnivzdorného skla nebo varné keramiky na plynovém nebo podobném vařiči, kde by byla bez rozptylovače nádoba ohřívána přímým plamenem. Rozptylovač zamezuje nerovnoměrnému ohřívání nádoby a tím snižuje na minimum riziko prasknutí nádoby po dobu ohřevu. Rozptylovač je tvořen kruhovým výsekem z ocelové síťoviny. Na obvodu je výsek vyztužený ocelovým lemem o průměru 200 mm.

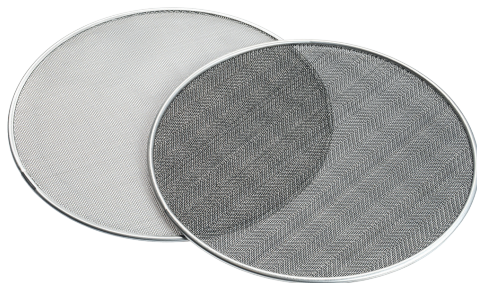



22

DETEKČNÍ TRUBIČKY AL – TEST

Objednávkové číslo	Typ	
253 219 810 900	sada 10 ks detekčních trubiček	Souprava Altest 10
253 219 810 901	sada 3 ks detekčních trubiček	Souprava Al-test 1
253 219 810 903	sada 1 ks detekčních trubiček Al-test 2	Al-test 2

Detekční trubičky se používají k orientačnímu zjišťování alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Souprava Al-test se skládá z deseti zatavených skleněných trubiček, z deseti náustků a odměrného sáčku na množství profouknutého vzduchu. Vše je vloženo do speciální plastové krabičky, která je opatřena kovovým ulamovačem konců detekčních trubiček. Souprava Al-test – 1 se skládá ze tří zatavených skleněných trubiček.




23

DETEKCE PLYNŮ A PAR – DETEKČNÍ TRUBICE



Objednávkové číslo	Typ	Měřicí rozsah	Počet zdvihů
253 219 810 830	CO 0,001	0,001–0,3%	1, 10
253 219 810 840	CO 0,5	0,5 – 5 %	1
253 219 810 850	CO 2	1%–16%	15–5
253 219 810 880	UH–V	0,5% 95%	1
253 219 810 890	KT 91	—	1

Detekční trubice CO a CO₂ jsou určeny pro orientační stanovení škodlivých plynů (oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého) v ovzduší. Detekční trubice UH – V jsou určeny pro stanovení uhlovodíků a dolní meze výbušnosti par ředidel v ovzduší. Detekční trubice KT – 1 slouží k určování směru proudění vzduchu. Detekční trubice jsou určeny pro jednorázové použití. Detekční trubice jsou na obou koncích vzduchotěsně zatavené, na povrchu trubic je znak výrobce, označení typu, počet zdvihů nasávacího zařízení potřebných pro provedení měření, stupnice a šipka označující směr proudění ovzduší při nasávání. Detekční trubice se používají ve spojení s nasávacím zařízením Universál nebo jiným podobným typem. Detekční trubičky KT – 1 se používají ve spojení s malým pryžovým balónkem.

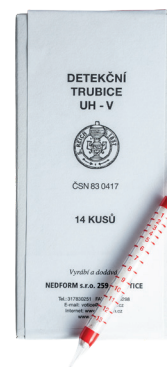

24
DETEKCE PLYNŮ A PAR – NASAVAČ UNIVERSAL 86

Objednávkové číslo	Rozměr	Měřicí rozsah
396 811 210 700	144 x 85 x 52	100 $\pm$ 5 cm ³

Nasavač se používá ve spojení s detekčními trubicemi k orientačnímu zjišťování koncentrace škodlivin v ovzduší. Nasavač tvoří pryžový měch oválného harmonikového tvaru, který je na obou koncích uzavřen plastovými bočnicemi. Na jednu bočnici je našroubována hlavice s pryžovým těsněním a na její olivku je navlečena pryžová hadice, do které se zasune detekční trubice. Vně měchu na bočnicích jsou upevněny dva omezovací řetízky, které zajišťují nastavení určitého nasávaného objemu vzdušiny. Na jednom řetízku bočnice je ulamovač konce detekční trubice. Nasavač je s pohotovostním pouzdem vložen do brašny.


25
DETEKCE PLYNŮ A PAR – NASAVAČ UNIVERSAL 86 BEZ BRAŠNY

Objednávkové číslo	Rozměr	Měřicí rozsah
396 811 210 701	144 x 85 x 52	100 $\pm$ 5 cm ³

Nasavač se používá ve spojení s detekčními trubicemi k orientačnímu zjišťování koncentrace škodlivin v ovzduší. Nasavač tvoří pryžový měch oválného harmonikového tvaru, který je na obou koncích uzavřen plastovými bočnicemi. Na jednu bočnici je našroubována hlavice s pryžovým těsněním a na její olivku je navlečena pryžová hadice, do které se zasune detekční trubice. Vně měchu na bočnicích jsou upevněny dva omezovací řetízky, které zajišťují nastavení určitého nasávaného objemu vzdušiny. Na jednom řetízku bočnice je ulamovač konce detekční trubice.


26
CHLORKOLORIMETR

Objednávkové číslo
396 121 310 300

Chlorkolorimetrem se zajišťuje obsah volného chloru v pitné, užitkové a odpadní vodě.



**27 VLNOVEC 250**

Objednávkové číslo

426 028 521 305

Náhradní díl k přečerpávacím čerpadlům typu „S“.

**28 VLNOVEC 900**

Objednávkové číslo

426 928 024 938

Náhradní díl k přečerpávacím čerpadlům typu „S“.

**29 VÍKO HORNÍ PRO IDPE 10 (200)**

Objednávkové číslo

632 612 003 004

Náhradní skleněné víko k destilačnímu přístroji IDPE10.

**30 VÍKO HORNÍ PRO DP 4 (150)**

Objednávkové číslo

632 612 002 029

Náhradní skleněné víko k destilačnímu přístroji DP4.

**31 VENTIL KOMPL. /8085/-SEDLO,VENTIL,MATICE**

Objednávkové číslo

426 928 041 919

Náhradní díl k přečerpávacím čerpadlům typu „S“.

**32 VÁLEC ČINNÝ KOMPL. 900 NT/ SKLO + PŘÍRUBY**

Objednávkové číslo

426 928 041 938

Náhradní díl k přečerpávacím čerpadlům typu „S“.

**33 VÁLEC ČINNÝ KOMPL. 250 NT/ SKLO + PŘÍRUBY**

Objednávkové číslo

426 928 041 928

Náhradní díl k přečerpávacím čerpadlům typu „S“.

**34 TRUBICE PRO PRŮTOKOMĚŘ R 3 U/ DN 15KZB**

Objednávkové číslo

632 252 034 002

Rozměr / Délka

300 mm

Náhradní skleněná trubice průtokoměru pro IDPE10-ZF.

**35 TĚSNĚNÍ DN 200**

Objednávkové číslo

9 180 001 375

Náhradní těsnicí prvek pro sestavu skleněných dílů IDPE10.

**36 TERMOSTAT PRO DP 4**

Objednávkové číslo

9 120 033 137

Bezpečnostní termostat pro DP4 (tepelná pojistka).





37 ŠROUBENÍ DN 25 KZ

Objednávkové číslo

9 120 008 173



Plastové šroubení pro skleněné armatury o DN25 / spojení přepadové trubice s kotlíkem IDPE10.

38 SVORKOVNÍCE KOMPL. K IDPE 10

Objednávkové číslo

632 921 522005



Náhradní svorkovnice pro IDPE10.

39 NOSNÁ KONSTRUKCE 7529/7-13

Objednávkové číslo

40 752 971 100



Nosná konstrukce pro DP4 - RZ a jeho zavěšení na zeď.

40 PŘEVLEČNÁ MATICE GL 32 NT

Objednávkové číslo

632 441 700 800



Převlečná matice pro upevnění odpadní trubice do trubice přepadové (IDPE10 + DP4).

41 PŘEPADOVÁ TRUBICE K IDPE 10 (SKLO)

Objednávkové číslo

632 611 619 122



Náhradní přepadová trubice (samostatné sklo) pro IDPE10.

42 PŘEPADOVÁ TRUBICE K IDPE 10 KOMPL.

Objednávkové číslo

632 611 151100



Náhradní přepadová trubice doplněná o přepadovou trubici, převlečnou matici, gumové těsnící pouzdro a zemnicí elektrodu pro IDPE10.

43 ODPADNÍ TRUBICE

Objednávkové číslo

632 449 941 800

Typ

DP 10

Rozměr / Délka

400 mm

632 449 941 700

DP 4

350 mm



Odpadní trubice pro IDPE10.

44 PRŮCHODKA SA DN 25

Objednávkové číslo

9 120 008 108



Slouží k bezpečnému a spolehlivému průchodu potrubí a zajišťuje jeho pevné a těsné uchycení v zařízení.

45 ODKALOVACÍ VLOŽKA DP 4

Objednávkové číslo

632 612 601 045



Odkalovací vložka k DP4.

46 NAPOJOVACÍ KONCOVKA S OLIVKOU

Objednávkové číslo

632 611 820 922



Přímá koncovka DN25 na hadičník (redukce).



47

KOTL. VARNÝ S CHLADIČEM PRO DP 4 RST (STOLNÍ)

Objednávkové číslo

632 611 619 045

Náhradní skleněný horní díl celého destilačního přístroje DP4ST s chladičem.



48

KOTL. VARNÝ S CHLADIČEM PRO DP 4 RZ (ZÁVĚSNÝ)

Objednávkové číslo

632 611 619 046

Náhradní skleněný díl těla DP4 s kotlíkem a chladičem.



49

VÍKO SPODNÍ S CHLADIČEM K IDPE 10

Objednávkové číslo

632 611 619 142

Náhradní spodní víko pro IDPE10 s chladičem.



50

KOTLÍK VARNÝ K IDPE 10 (DĚLENÝ)

Objednávkové číslo

632 611 619 141

Náhradní skleněný díl varného kotlíku pro IDPE10.



51

KORÁLE PODLOŽNÉ

Objednávkové číslo

9 180 000 508

Typ

DN 100

9 180 000 510

DN 150

9 180 000 511

DN 200

Distanční podložné korále pro kompletaci destilační aparatury IDPE10/DP4.



52

FILTR ZMĚKČOVACÍ K IDPE - 10 ZF NOVÉ PROV. ZF NOVÉ PROV.

Objednávkové číslo

632 612 010 014

Samostatná skleněná aparatura pro předúpravu vody do destilačního přístroje.



53

GRAFITOVÉ TOPENÍ K IDPE 10 (TVRDÁ VODA 19-25)

Objednávkové číslo

632 931 001 111

Topná elektroda pro IDPE10 s velmi tvrdou vstupní vodou (nad 25N) a častým provozem.



54

GRAFITOVÉ TOPENÍ K IDPE 4

Objednávkové číslo

632 931 001 041

Náhradní topná elektroda pro starší typy DP4 - cca od roku 1990.



**55**

ELEKTRODOVÉ TOPENÍ K IDPE 10 (19–25)

Objednávkové číslo

632 931 002 103

Nerezové elektrodové topení pro IDPE10 (tvrdá voda 19–25N).

**56**

ELEKTRODOVÉ TOPENÍ K IDPE 10 (8–18)

Objednávkové číslo

632 931 002 102

Nerezové elektrodové topení pro IDPE10 (středně tvrdá voda 8–18 N).


**57**

ELEKTRODOVÉ TOPENÍ K IDPE 10 (4–7)

Objednávkové číslo

632 931 002 101

Nerezové elektrodové topení pro IDPE10 (měkká voda 4–7N).

**58**

TĚLESO TOPNÉ 2,8W DP –4RZ,RS

Objednávkové číslo

9 120 006 772

Náhradní topná spirála s přímým ohřevem pro DP4.



FAKTURAČNÍ ADRESA:

NEDFORM S.R.O.
HRANICKÁ 20
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
757 01
ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 25383973
JEDNATEL KRYŠTOF BAJGAR (+420 722 942 102)
E-MAILOVÁ ADRESA SÍDLA: INFO@NEDFORM.CZ
TELEFONNÍ SPOJENÍ PRO SÍDLO VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ: 571620409

POBOČKA BENEŠOV

NEDFORM S.R.O.
ANTŮŠKOVA 266
BENEŠOV
256 01
ČESKÁ REPUBLIKA
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE EVA MATOUŠOVÁ (+420 602 156 791)
E-MAILOVÁ ADRESA POBOČKY: ESHOP@NEDFORM.CZ



WWW.NEDFORM.CZ

NEDFORM

